ACCU-CHEK® Go

MEDIDOR DE GLUCEMIA

Guía rápida de instrucciones

⚠ Esta Guía Rápida no reemplaza la información detallada de las instrucciones de uso de su medidor de glucemia Accu-Chek Go. Por favor, tenga en cuenta las advertencias de seguridad que se encuentran en las instrucciones de uso.

1.

2.

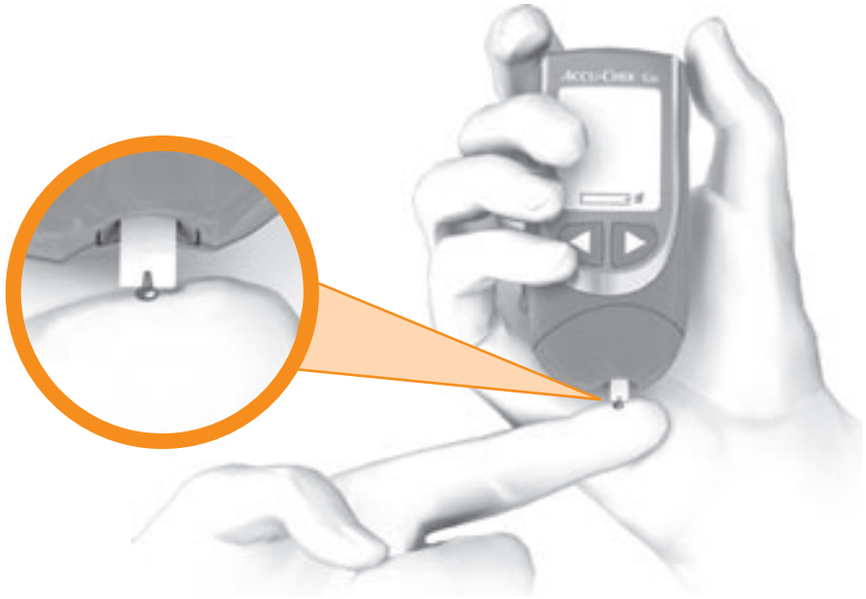

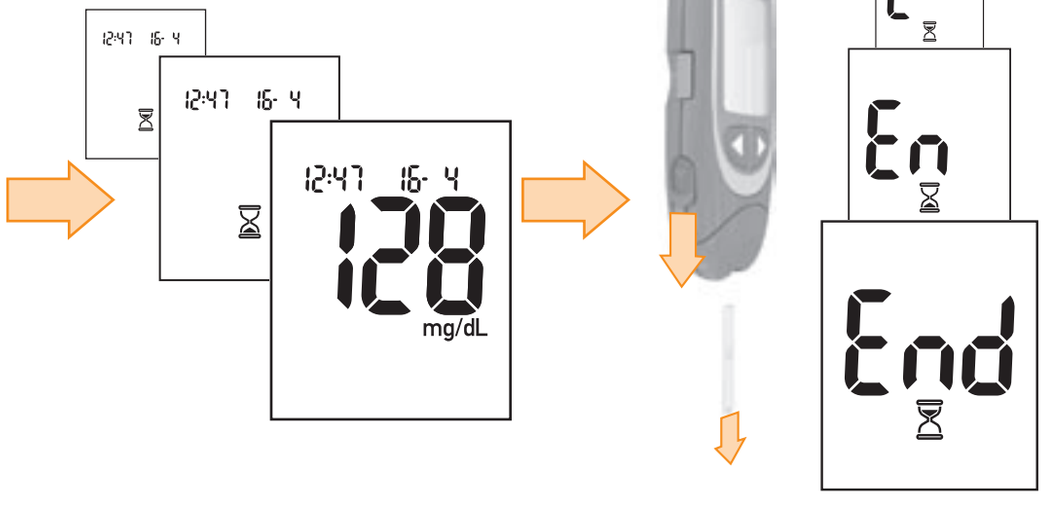

CE 0088

ACCU-CHEK y ACCU-CHEK GO son marcas de fábrica de Roche.

Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

QRG for 0 4829271001(02) 09/06

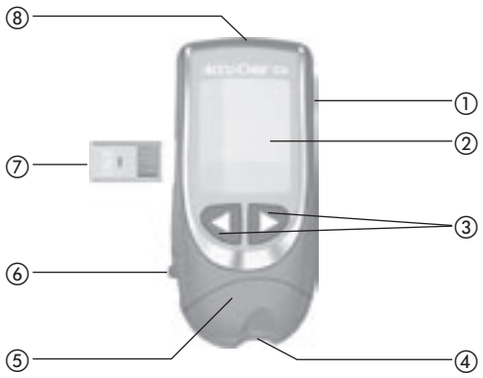

Cara frontal y superficies laterales

① Tecla ◉: encender y/o apagar. Entrar en los modos de ajuste para realizar cambios y guardarlos

② Pantalla LC

③ Teclas ◀ y ▶: cambiar ajustes (retroceder y avanzar), ver los resultados y los valores promedio

④ Guía para la tira reactiva – por aquí se introduce la tira reactiva

⑤ Tapa de la lente de medición

⑥ Eyector de tiras reactivas

⑦ Chip de codificación

⑧ Interfaz para infrarrojos para la transferencia de los resultados, p.ej. a una computadora

Cara posterior

⑦ Chip de codificación

⑨ Ranura para el chip de codificación

⑩ Placa de características

⑪ Compartimento de la pila

⑫ Pila (Tipo CR 2032)

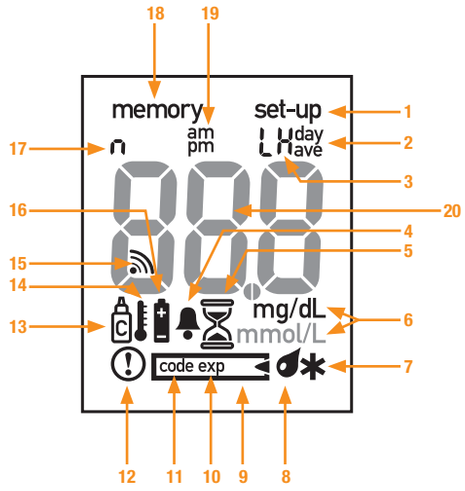

1 Medidor en el modo de ajuste

2 al mostrar el valor promedio: número de los días que se tuvieron en cuenta

3 LH o LL: ajustar el rango individual admisible (modo de ajuste)

4 recordatorio de prueba activado, parpadeando: mensaje en la pantalla mientras que suena el recordatorio de prueba

5 la medición o el cálculo de los valores promedio está en proceso

6 unidad de medida del resultado de glucemia

7 marca para un resultado especial

8 parpadeando: aplicar sangre a la tira reactiva ahora

9 parpadeando: introducir la tira reactiva ahora

10 la fecha de caducidad de la tira reactiva ha expirado

11 aparece el número de código, parpadeando: falta el chip de codificación

12 ajustar el rango individual admisible (modo de ajuste), parpadeando: el resultado está fuera del rango individual admisible

13 marca para una prueba de control de funcionamiento

14 parpadeando: la temperatura está fuera del rango admisible

15 señal sonora o modo acústico activado

16 parpadeando: la pila se está descargando

17 cuando aparece el valor promedio: número de resultados tenidos en cuenta para el cálculo

18 memoria de resultados, valores promedio o transferencia de resultados

19 Información adicional en el formato 12 horas

20 **Mensajes en el centro de la pantalla**

`---` Chip de codificación falta; en la memoria de resultados: la memoria está vacía, no se puede calcular los valores promedio o el resultado ha sido borrado,

`AL` Ajuste del recordatorio de prueba (modo de ajuste)

`Clr` parpadeando: borrar el resultado más reciente

`End` fin del modo de ajuste, concluido el autocontrol después de la prueba o la transferencia de datos

`F` Modo de Ajuste Rápido: escoger un grupo

`Hi` Messwert >600 mg/dL (33,3 mmol/L)

`Lo` Messwert <10 mg/dL (0,6 mmol/L)

`PC` Übertragung Messwerte

Modo de Ajuste Rápido: cambiar ajustes

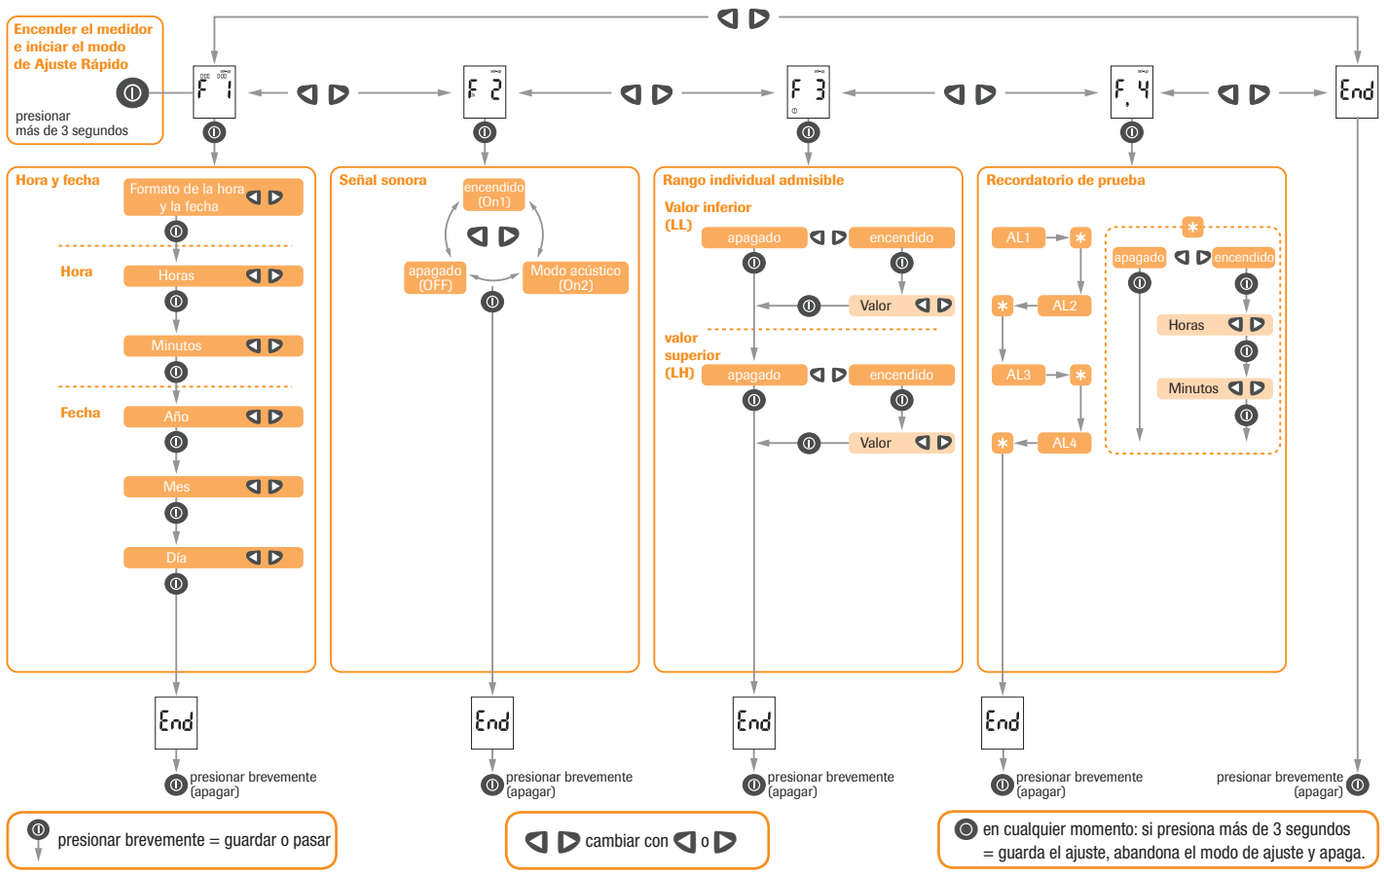

Mensajes de error

`E-1` La tira reactiva ha sido introducida incorrectamente, tira reactiva ha sido movida o doblada, fuerte fuente electromagnética

`E-2` fuente electromagnética
Chip de codificación de otro sistema. chip de codificación ilegible, chip de codificación defectuoso, chip de codificación fue extraído durante la prueba

`E-4` Lente de medición óptica sucia, la tira reactiva ha absorbido sangre antes de tiempo, la tira reactiva ha sido movida/doblada, tira reactiva ya usada, la fecha de caducidad de la tira ha expirado, después de la prueba la nueva tira reactiva ha sido introducida antes de tiempo (durante el mensaje End)

`E-6` La tira reactiva no ha absorbido suficiente sangre, la tira reactiva ha sido movida/doblada, pila descargada, falla en el medidor, fuerte fuente electromagnética

`EEE` Falla en el medidor

`ttt` Temperatura demasiado alta o baja para realizar la prueba